

< 17-31 >
2017年12月

先生各位

「HBs 抗体(精密測定)」 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、下記検査項目におきまして試薬メーカーより測定の際に使用する基準物質を WHO1st から WHO2nd に変更する旨、連絡がございましたのでご案内申し上げます。

何卒ご高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■対象項目 : HBs 抗体(精密測定)

[項目コード:280]

■検査内容変更実施日:

2018年 2月 5日(月)受付分より

以上

※裏面もご覧ください。


●変更内容：

変更内容	新	現
検査方法	CLIA	CLIA
基準物質	WHO2 nd	WHO1 st
基準値	陰性 10.0 mIU/mL未満	陰性 10.0 mIU/mL未満
報告範囲	2.5 未満 2.5 ~ 999 1,000 以上	10.0 未満 10.0 ~ 99,999 100,000 以上
備考	基準値について WHOの勧告では、B型肝炎ウイルス感染防御機能を持つHBs抗体濃度は10.0 mIU/mL以上とされています。	

※検査方法・基準値について変更はございません。

《 現試薬と新試薬の比較 》

[全 体]

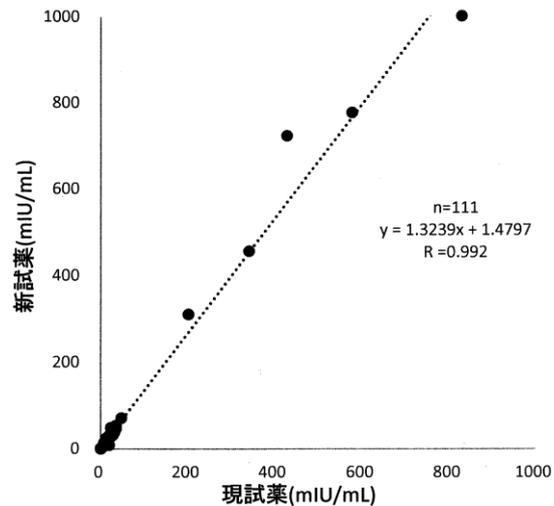

[低濃度]

